



Centro de Estudios de Ciencias Alternativas (CECA)

Centro de Investigación Científica y Enseñanza Polimodal Parasistemática

Sujeto a normas de derecho común, Artículo 24.1 de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación, del 3/07/85. Acogidos al artículo 35, Decreto 70/76 de 5 de marzo, según el art.43 Orden Ministerial 5/2/79 B.O.E. de 19/2/79 de Ordenación de la Formación Profesional. Ministerio de Educación y Cultura de España
Inscripta en el Ministerio de Educación de la Nación Argentina a los efectos laborales SNEP Registro 5951/88 Ley 13047 y 1°Dec. 40471/47

INSTRUCTIVO DE RADIONIC POWER PRO

(Se recomienda imprimir el presente manual instructivo)

Introducción:

El Centro de Estudios de Ciencias Alternativas (CECA), presenta, a través de su titular: Manuel Santos Prieto (Técnico Químico y Terapeuta Holístico Mat. 4005) este material informático para la aplicación de técnicas radiónicas y estimulación de las energías sutiles del organismo, especialmente requerido por profesionales en técnicas radiónicas y disciplinas afines, (Teleradiestesistas, terapeutas en Psicorelax, Reiki, Yoga, etc.) y para cualquier persona interesada que quiera beneficiarse con su uso.

Para incrementar los efectos de aplicación del programa puede utilizar los módulos inductores bioenergéticos Fu Xi y Wen Wang utilizados en el tratamiento de BioCibernética Quántica Holográfica, (que se envían con el programa informático apropiado para recargarlos), por solicitud expresa y no incluidos con la entrega del presente programa. La información se encuentra en el archivo “Opción de uso del Make Vibration.pdf” dentro del DVD.

En el proceso de instalación se creará una carpeta (directorio) en la partición C del disco duro de su ordenador, llamada “Radionic Power Pro” que, entre otras cosas, contendrá una serie de informes técnicos y científicos como apoyo para profesionales o aprendizaje y conocimientos indispensables para las personas interesadas que no hayan avanzado tanto en las disciplinas de Radiónica y Geobiología, pero que serán sumamente útiles en el proceso de uso del presente programa.

Esos Informes son:

- 01 Radiónica - Conceptos sobre Energía Vibracional.pdf
- 02 Radiónica - Ondas de forma y física cuántica.pdf
- 03 Radiónica Bioelectromagnetismo I Parte.pdf
- 04 Radiónica Bioelectromagnetismo III Parte Efectos de las radiaciones electromagnéticas.pdf
- 05 Graficas Radiónicas Tratamiento.pdf
- 06 Curso Chakras1.pdf
- 07 Glándula Pineal.pdf

Secciones de la obra:

INSTRUCTIVO DE OPERACIONES:

APLICACION DE ENERGIZACIÓN/ALINEACIÓN DE CHAKRAS:

APLICACION DE ENERGIZACIÓN/LIMPIEZA DEL BIOCAMPO:

APLICACION DE ENERGIZACIÓN Y ACTIVACION DE LA GLANDULA PINEAL:

APLICACIONES DE TRATAMIENTOS CON RADIONICA HOLOGRAMICA:

APLICACIONES CON EQUIPO RADIONICO HIERONYMUS:

Breve Introducción para el uso del Biómetro de Bovis:

Equivalencias entre UB y KUB:

Nociónes de energías radiativas y no radiativas:

APLICACIONES CON GRAFICAS RADIÓNÍCAS DE TRATAMIENTO:

SOBRE LAS SESIONES Y APLICACIONES:

El tipo de aplicación necesaria y la cantidad o repetición de las sesiones serán establecidas por su criterio de acuerdo al seguimiento de cada individuo y ponderando el avance en el tratamiento de cada caso.

Antes de continuar, lea atentamente los informes técnicos que se han incorporado en la carpeta del programa, puesto que así sabrá la forma correcta de encarar cada situación, principalmente para adquirir los conocimientos necesarios del tratamiento vibracional y plantearse una buena estrategia de diagnóstico y elegir las sesiones necesarias para cada caso.

No está de más recordarle que las sesiones para Alineación de chakras, Descontaminación vibracional del Biocampo, Descalcificación de Glándula Pineal y Reconexión por método Schumann pueden realizarse sin problemas aún sin un método diagnóstico que las justifique, puesto que en mayor o menor medida, estos centros energéticos o situaciones vibracionales del organismo son proclives a desequilibrarse, ya sea por influencias energéticas del entorno o disfunciones propias del mismo sujeto.

NOTA:

Nunca descarte las informaciones de diagnóstico médico puesto que son verdaderos pilares sobre los que apoyarnos cuando realicemos nuestra evaluación, y nunca olvide que nuestra diagnóstico corresponde al plano vibratorio del organismo, no diagnosticamos enfermedades o patologías clínicamente, sino como posibilidades de afección para futuras aplicaciones coadyuvantes de tratamientos.

Se le ha entregado el material técnico necesario para que conozca las características de cada aplicación y los medios para evaluar por su cuenta cada situación en particular, aún así, de no ser usted un profesional, le damos las siguientes indicaciones:

¿Por cuantos días repetir las sesiones?

Puede averiguar hasta cuándo será suficiente realizar las sesiones para una persona utilizando los métodos de diagnosis a los que usted esté acostumbrado, péndulo, biómetros, entrevista personal, etc. (los que utiliza habitualmente para seguimiento de tratamientos), si no lo sabe, lo normal es:

Para Chakras Principales o Secundarios:

Hasta dos sesiones por persona y por día durante 4 días. (ejemplo: una sesión para el 5ºchakra a las 10 de la mañana y otra a las 4 de la tarde, o las dos sesiones consecutivas a la misma hora, suficientes para esa persona y para ese día).

Para descontaminación del Biocampo:

Hasta dos sesiones por persona y por día durante 4 días.

Para descalcificación de glándula Pineal:

Hasta dos sesiones por persona y por día durante 5 días.

Para Reconexión con ondas Schumann:

Hasta dos sesiones por persona y por día durante 6 días.


INSTRUCTIVO DE OPERACIONES:

Las partes centrales del programa en cuanto a su nivel aplicativo son:

1. Energización, desbloqueo y alineación de vórtices energéticos magnos (Chakras).
2. Energización y reequilibrio del Biocampo electromagnético corporal (Aura).
3. Estimulación de la Glándula Pineal.
4. Aplicación de Teleradiónica (Energización a distancia), a través del Equipo Radiónico Hieronymus, diseñado a tal efecto.
5. Aplicación de Teleradiónica a través de potenciación y protección de testigo (persona) mediante gráficas Radiónicas de Tratamiento.

Haré una descripción de los procesos y usos del programa a medida que usted ejecuta los siguientes pasos:

De la pantalla de Bienvenida puede salir presionando el botón “Abandonar” o dejarlo abierto para ir recorriendo el programa a medida que estudia el presente instructivo.

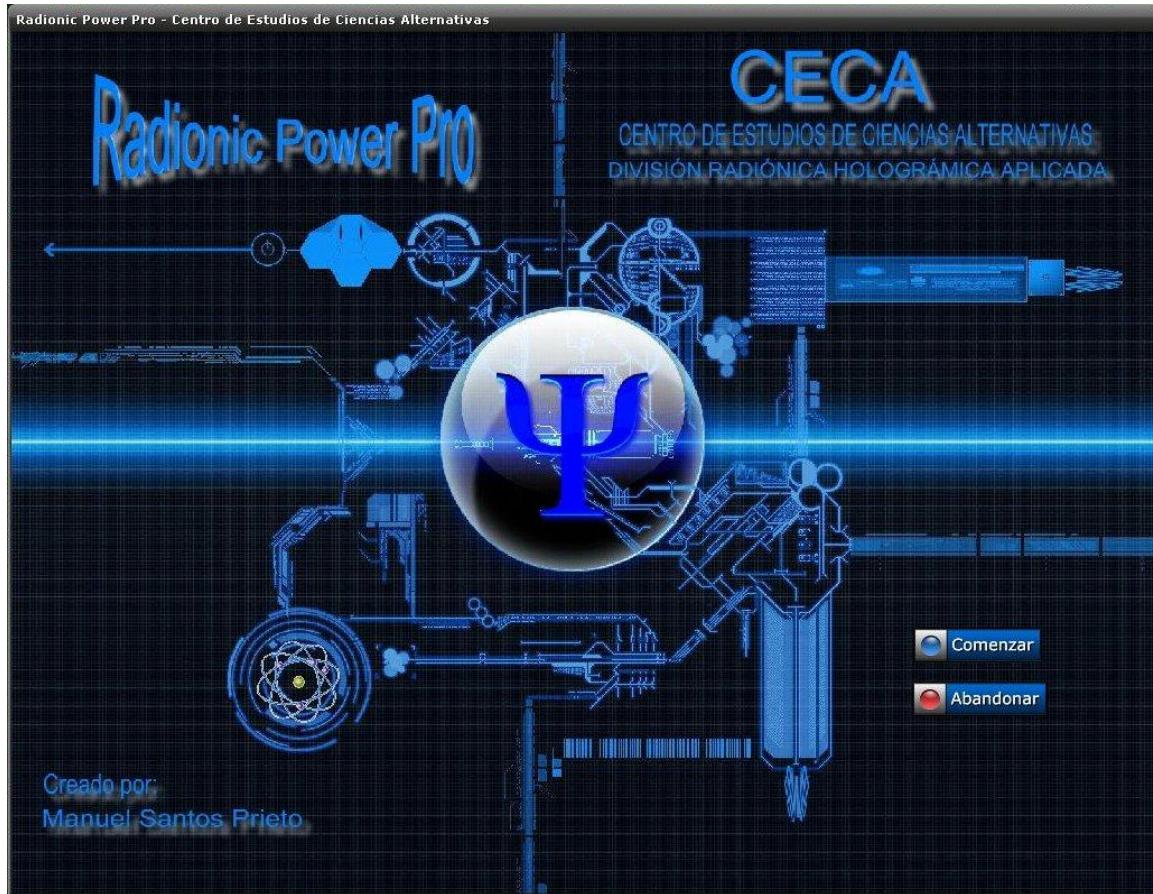

Como en sus aplicaciones muchas veces tendrá que trabajar a distancia lo mínimo que debe tener de una persona son: su nombre completo, su fecha de nacimiento y una fotografía.

Cuando tenga la foto de la persona descargada en su ordenador, es indispensable que coloque el archivo de la foto de la persona dentro de la carpeta "Radionic Power Pro" con el nombre "person1" o "person2", que usará el programa para mostrar la imagen de la persona, es decir, si es mujer le pondrá el nombre de archivo person1.jpg y si es hombre el nombre person2.jpg, asegúrese de que la extensión de los archivos de imagen sea "JPG".

Obviamente que en la fotografía debe aparecer solamente la persona a tratar y lo ideal sería trabajar con una imagen de la cara de la persona, pero no se preocupe si tiene una de cuerpo entero, porque el programa reajusta el tamaño de la imagen para usarla en el proceso.

Nota:

Si no tiene una fotografía tipo carné de la cara de la persona, o la foto es de un grupo de personas, en cualquier programa gestor de imágenes sencillo puede realizar el proceso de cortar de la foto solo el rostro y crear la imagen deseada. Las dimensiones recomendadas son 230x300 pixeles.



Colocar los archivos de imagen en el directorio donde se instaló el programa (C:\Radionic Power Pro) es lo único que debe hacer para que el programa reconozca, lógicamente, la imagen que debe tratar.
Una vez dentro del programa en la página de bienvenida presione el botón “Comenzar”.

En Casos de no disponer una fotografía del sujeto dentro del programa:

De todos modos, y previniendo que el operador no supiera utilizar un programa para gestionar las imágenes para incorporar al programa, o para casos en que no posea una imagen pero sí algo perteneciente a la persona a tratar (muestra, como cabello, pañuelo, etc.) se ha dispuesto un mecanismo de comunicación “virtual” entre la foto/muestra y las aplicaciones del programa.


El operador notará en las pantallas de aplicación un ícono con forma de mouse, pues bien, en caso de **no** tener la foto de la persona insertada en el programa, el operador colocará la foto o muestra del sujeto debajo del ratón, previamente habiendo cargado en la pantalla de aplicación los datos necesarios según se requiera en cada proceso, (nombre del sujeto, fecha de nacimiento, códigos, gráficas, etc.) y habiendo hecho un clic sobre el ícono del mouse (notará que parpadeará el ícono de forma luminosa), se está en condiciones de utilizar el mouse como enlace virtual con el programa.

Antes de colocar el mouse sobre la foto o muestra asegúrese de haber cliqueado el ícono del mismo y también el botón para activar el proceso de una aplicación.

Ejemplo: en la pantalla de Energización de chakras, una vez que ha colocado el nombre y fecha de nacimiento del sujeto (nºs 3 y 4), haga clic en el ícono del ratón (nº 6), luego el botón de inicio de la aplicación (nº 5) e inmediatamente deje el ratón sobre la foto o muestra del sujeto hasta que termine el proceso. No importa donde quede posicionado el puntero del ratón.



Eso lo situará en la pantalla de elección de Aplicaciones:

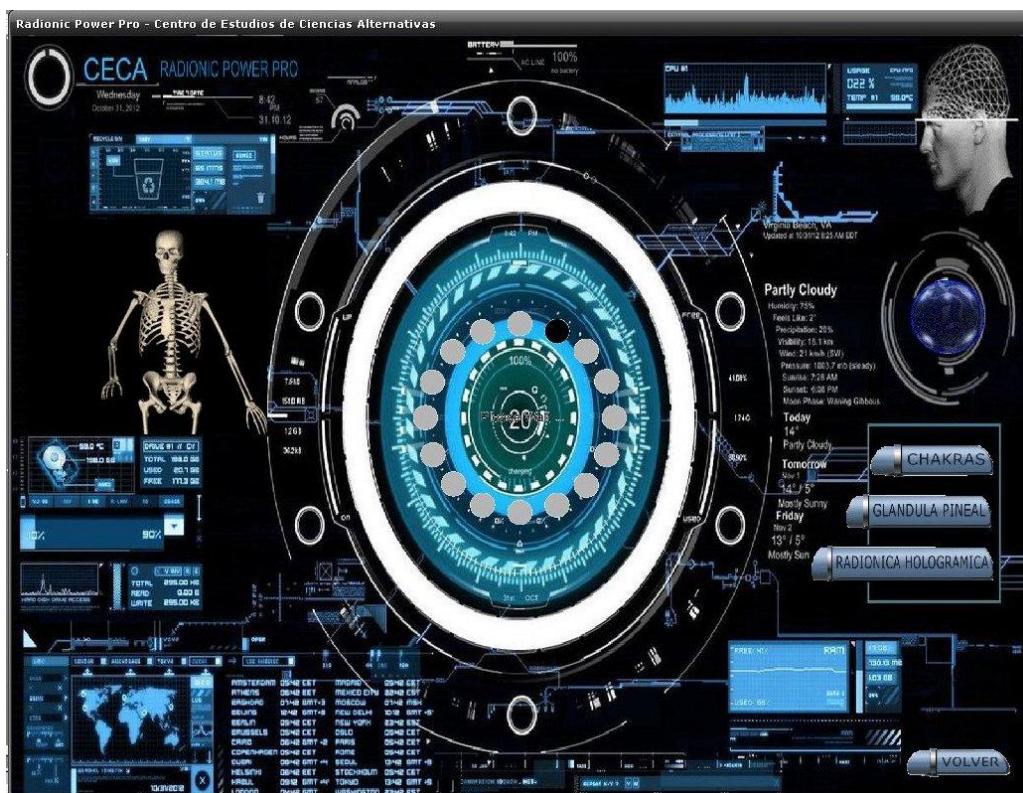

Esta consta de tres botones para elegir una aplicación de trabajo específica y un botón (ángulo inferior derecho), para volver a la página de bienvenida.

El botón “CHAKRAS” lo situará en la pantalla de aplicaciones para tratar energéticamente cualquiera de los 7 vórtices energéticos magnos o principales del cuerpo, y la alternativa de potenciar el Biocampo o Aura electromagnética.

El botón “GLANDULA PINEAL” lo situará en la pantalla de aplicación de reequilibrar y potenciar la glándula pineal o epífisis.

El botón “RADIÓNICA HOLOGRÁMICA” lo situará en la pantalla de aplicaciones de teleradiónica o tratamiento radiónico a distancia, dentro hay dos modelos o secciones para elegir, aplicaciones con el equipo radiestésico Hieronymus o con el uso de Gráficas Radiónicas de Tratamiento.

APLICACION DE ENERGIZACIÓN/ALINEACIÓN DE CHAKRAS:


Como todas las aplicaciones del Radionic Power Pro, esta aplicación puede ser personalizada, es decir, la persona a tratar puede estar situada frente al ordenador, o ser tratada a distancia.

Nota:

Llegado a este punto el operador puede (o debería) realizar un diagnóstico radiestésico para evaluar con su péndulo el o los chakras a tratar en una persona, para lo cual también he incorporado una Gráfica Radiónica de Diagnóstico para tal efecto, la cual puede redimensionar e imprimir para su uso.

Es un gráfico circular, lo que indica que el código de movimiento del péndulo no puede ser “por oscilación”, sino por “sentido de giro” (por ejemplo giro en sentido de las agujas del reloj significa “Sí”, en sentido contrario significa “No”, mientras se recorre con el péndulo los sectores de cada chakra comenzando por el primero).


ELECCIÓN DEL CHAKRA

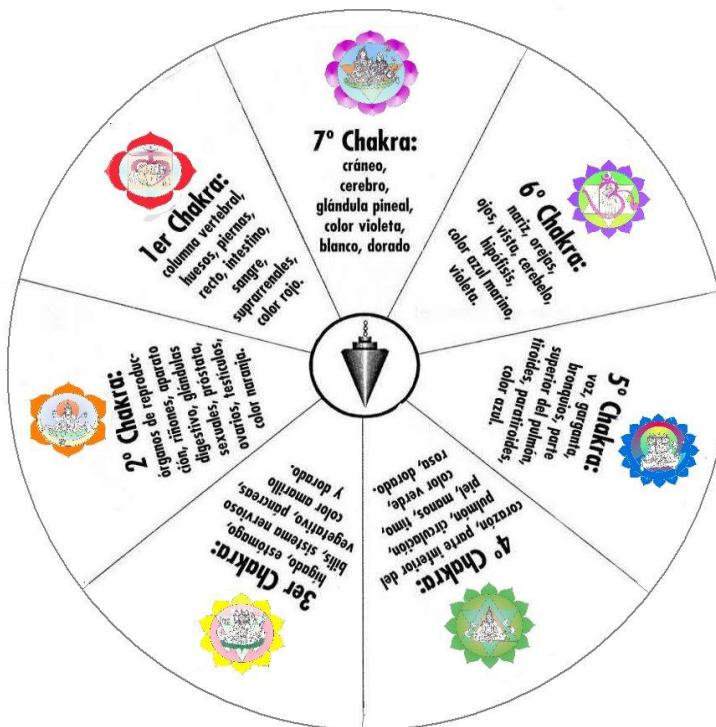

En el módulo o pantalla de aplicaciones aparecen 2 sectores principales, (ver imagen).

El sector “CHAKRAS”, donde están alineados simbólicamente y horizontalmente los siete chakras, según su color específico, comenzando por el 1º chakra (rojo), y el sector (2) Biocampo.

Si se van a tratar los chakras y el Biocampo es recomendable tratar primeramente los chakras antes que el Biocampo electromagnético.

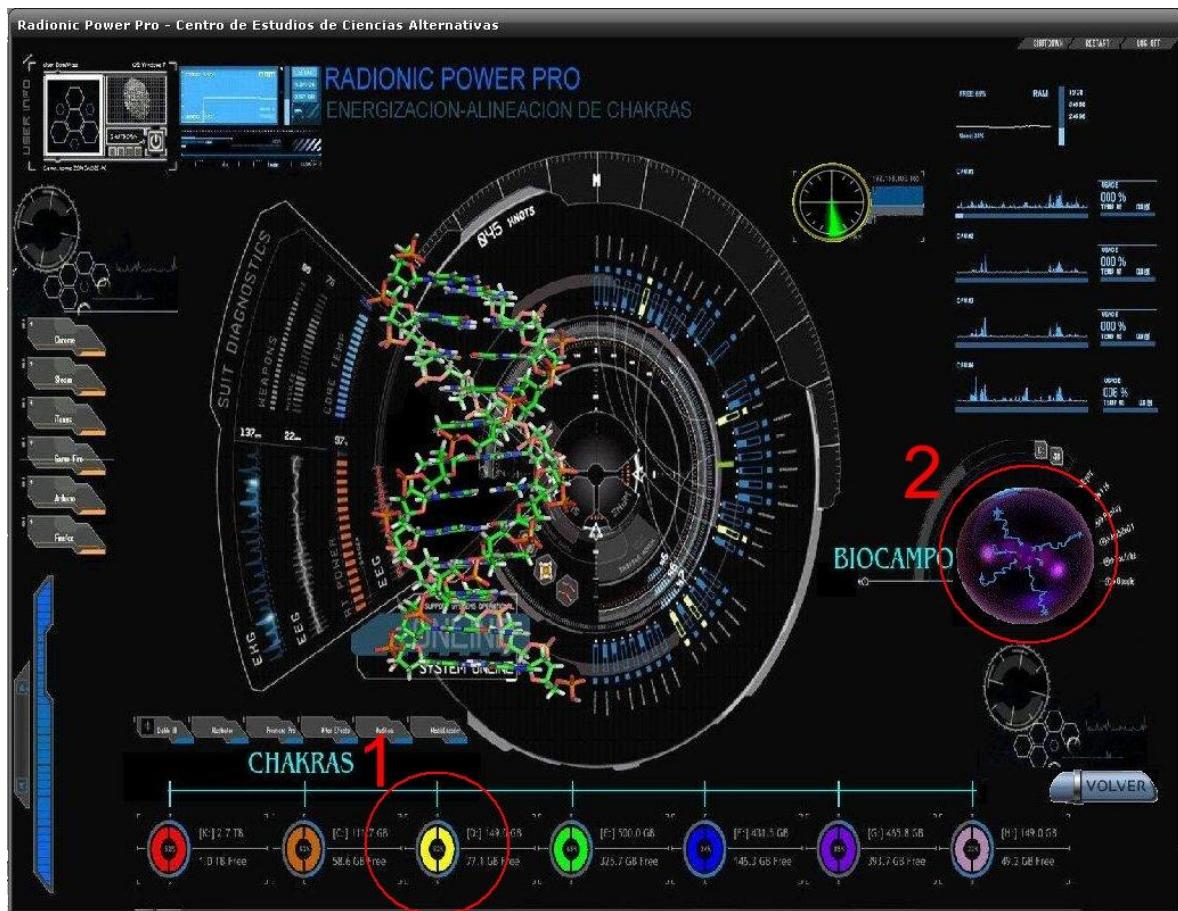

Supongamos que se ha decidido tratar energéticamente el 3º chakra (marcado en la imagen con el círculo rojo), se busca el ícono que corresponde a éste chakra, de color amarillo, y se hace clic sobre el mismo. Aparece entonces la pantalla de aplicación para el 3º chakra, con el símbolo propio del chakra a la derecha de la zona de reproducción de video, y que tiene las siguientes señales:



El sector de selección de la persona (1) dos iconos que representan a una mujer y un hombre. Si la persona a tratar es mujer presionamos el ícono que representa a la mujer y aparecerá la fotografía de la persona (mujer) que vamos a tratar en el sector (2), (recuerde que previamente se ha cargado la foto como archivo "person1" en el directorio del Radionic Power Pro).

Por el contrario, si la persona a tratar es varón, hacemos clic en el ícono de hombre y aparecerá la foto de la persona (hombre) en el sector (2).

En el sector marcado como (3) se coloca el nombre de la persona y al lado (sector marcado como (4)), la fecha de nacimiento, en expresión dd/mm/año, por ejemplo 10/09/1993 (10 de setiembre de 1993).

Una vez que tenemos a la vista la foto y hemos colocado el nombre y la fecha de nacimiento de la persona damos clic al botón "ACTIVAR CHAKRA" (5), y comenzará a ejecutarse el tratamiento sonoro para reequilibrar/energizar y alinear el tercer chakra.

El nº 6 indica la posición del icono del ratón que hay que cliquear como última maniobra después de cargar todos los datos y antes de colocar una foto o muestra del sujeto debajo del ratón.


Los videos están diseñados específicamente empleando las técnicas de cromoterapia y musicoterapia, ya que emiten un color luminoso y una sonoridad específica para influir potenciando, equilibrando y alineando cada chakra en particular.

Obviamente que si la aplicación no es personalizada, el mayor efecto que llegará a distancia a la persona será el de vibración sonora mucho más que la vibración cromática.

Una vez concluido el video el operador ya puede REPETIR LA SESION o volver a la página de Chakras haciendo clic sobre el botón "volver" (7).

APLICACION DE ENERGIZACIÓN/LIMPIEZA DEL BIOCAMP:

En la pantalla de aplicación para chakras se encuentra la opción para energizar y potenciar el Biocampo electromagnético, para ello haga clic sobre el sector (2) cerca de la indicación "BIOCAMP". La pantalla de aplicación posee el sector de selección de la persona (1) con dos iconos que representan a una mujer y un hombre, la fotografía de la persona que vamos a tratar en el sector (2), un sector para colocar el nombre (3) y otro para la fecha de nacimiento (4).

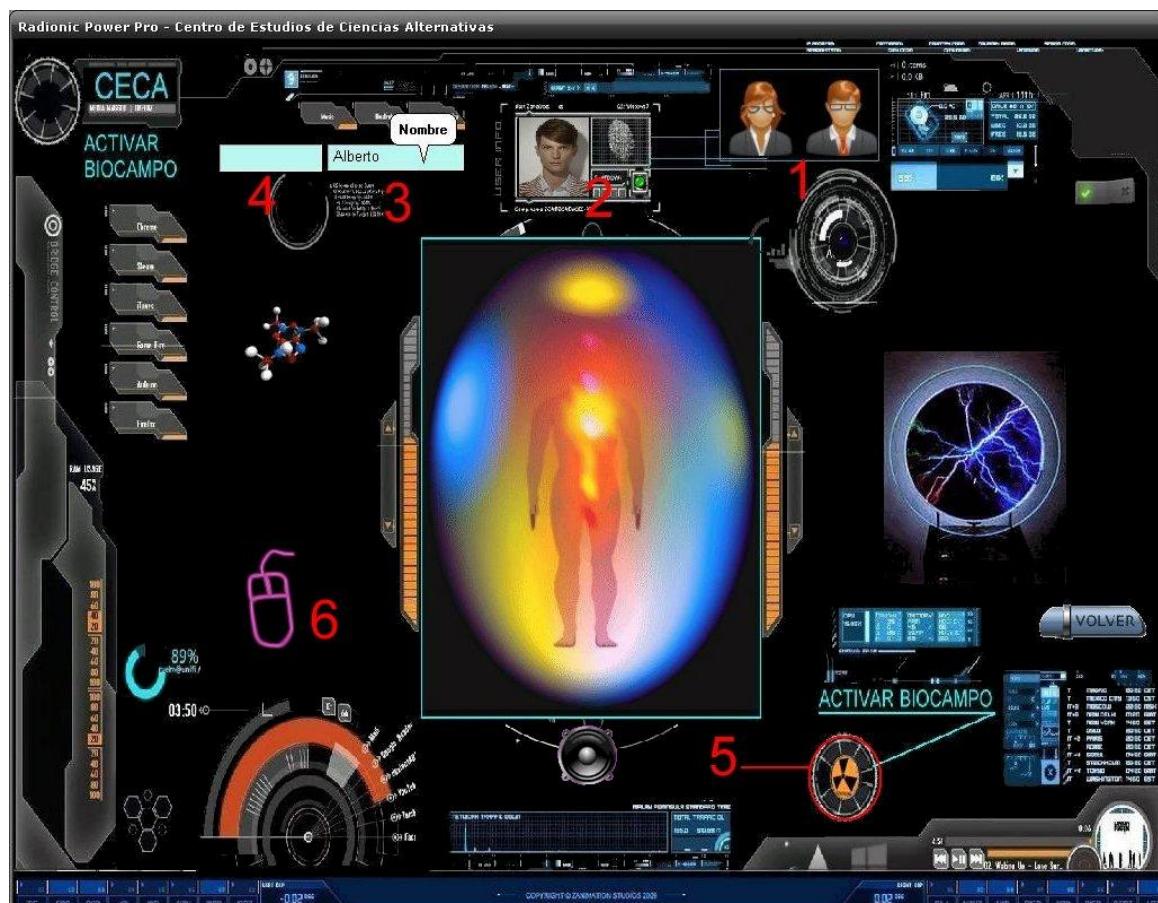

Lo único que hay que hacer es cliquear sobre el botón del sector (5), que está señalado por el mensaje “ACTIVAR BIOCAMP” y comenzará la aplicación cromática y sonora para potenciar y limpiar el Biocampo electromagnético corporal. Los principios de aplicación siempre son cromáticos y sonoros. El nº 6 indica la posición del icono del ratón que hay que cliquear como última maniobra después de cargar todos los datos y antes de colocar una foto o muestra del sujeto debajo del ratón.

Una vez concluida la aplicación el operador puede REPETIR LA SESIÓN o volver a la página de Chakras haciendo clic sobre el botón “volver”.

APLICACION DE DESCALCIFICACIÓN Y ACTIVACION DE LA GLANDULA PINEAL:

Llegamos aquí cliqueando sobre el botón “GLÁNDULA PINEAL” de la pantalla primaria de aplicaciones.

Posee el sector de selección de la persona (1) dos iconos que representan a una mujer y un hombre, y aparecerá la fotografía de la persona que vamos a tratar en el sector (2), (recuerde que previamente se ha cargado la foto como archivo “person1” o “person2” en el directorio del Radionic Power Pro).

En el sector marcado como (3) se coloca el nombre de la persona y al lado (sector marcado como (4)), la fecha de nacimiento, en expresión dd/mm/año, por ejemplo 10/09/1993 (10 de setiembre de 1993), y el botón para reproducción multimedia (5).

Solo resta presionar el botón (5) y comenzará la estimulación visual y sonora para la glándula pineal. El nº 6 indica la posición del icono del ratón que hay que cliquear como última maniobra después de cargar todos los datos y antes de colocar una foto o muestra del sujeto debajo del ratón.



NOTA:

Como los efectos sobre esta glándula son de doble efecto: por un lado la información que recibe la retina y envía al cerebro, y la vibración en ondas escalares provenientes del sonido (música especialmente

elaborada), los efectos son mucho más fuertes si el sujeto realiza la experiencia personalmente, frente al ordenador.

APLICACIONES DE TRATAMIENTOS CON RADIONICA HOLOGRAMICA:

Llegamos aquí al haber hecho clic sobre el botón “RADIÓNICA HOLOGRÁMICA” de la pantalla de aplicaciones primarias. Esta es la pantalla de aplicaciones de teleradiónica o tratamiento radiónico a distancia, dentro hay dos modelos o secciones para elegir: Las aplicaciones con el equipo radiestésico Hieronymus (1), o con el uso de Gráficas Radiónicas de Tratamiento (2).


NOTA:

Nunca descarte las informaciones de diagnóstico médico puesto que son verdaderos pilares sobre los que apoyarnos cuando realicemos nuestra evaluación, y nunca olvide que nuestra diagnosis corresponde al plano vibratorio del organismo, no diagnosticamos enfermedades o patologías clínicamente, sino como posibilidades de afección para futuras aplicaciones coadyuvantes de tratamientos.




APLICACIONES CON EQUIPO RADIONICO HIERONYMUS:

Si ha optado por hacer un tratamiento con el equipo Hieronymus se encontrará con la página de la siguiente figura, la cual está basada fielmente en el modelo de la máquina creada por Thomas Galen Hieronymus, uno de los grandes personajes de la radiónica de todos los tiempos, tanto por sus teorías como por sus diseños de dispositivos. Su máquina para tratamiento (modificada para teleradiónica por el investigador John Campbell), alcanzó gran popularidad y hoy en día entre los aficionados y profesionales siempre es ansiado tener uno de sus dispositivos; abrió incluso el camino a la radiónica simbólica y la psiónica.

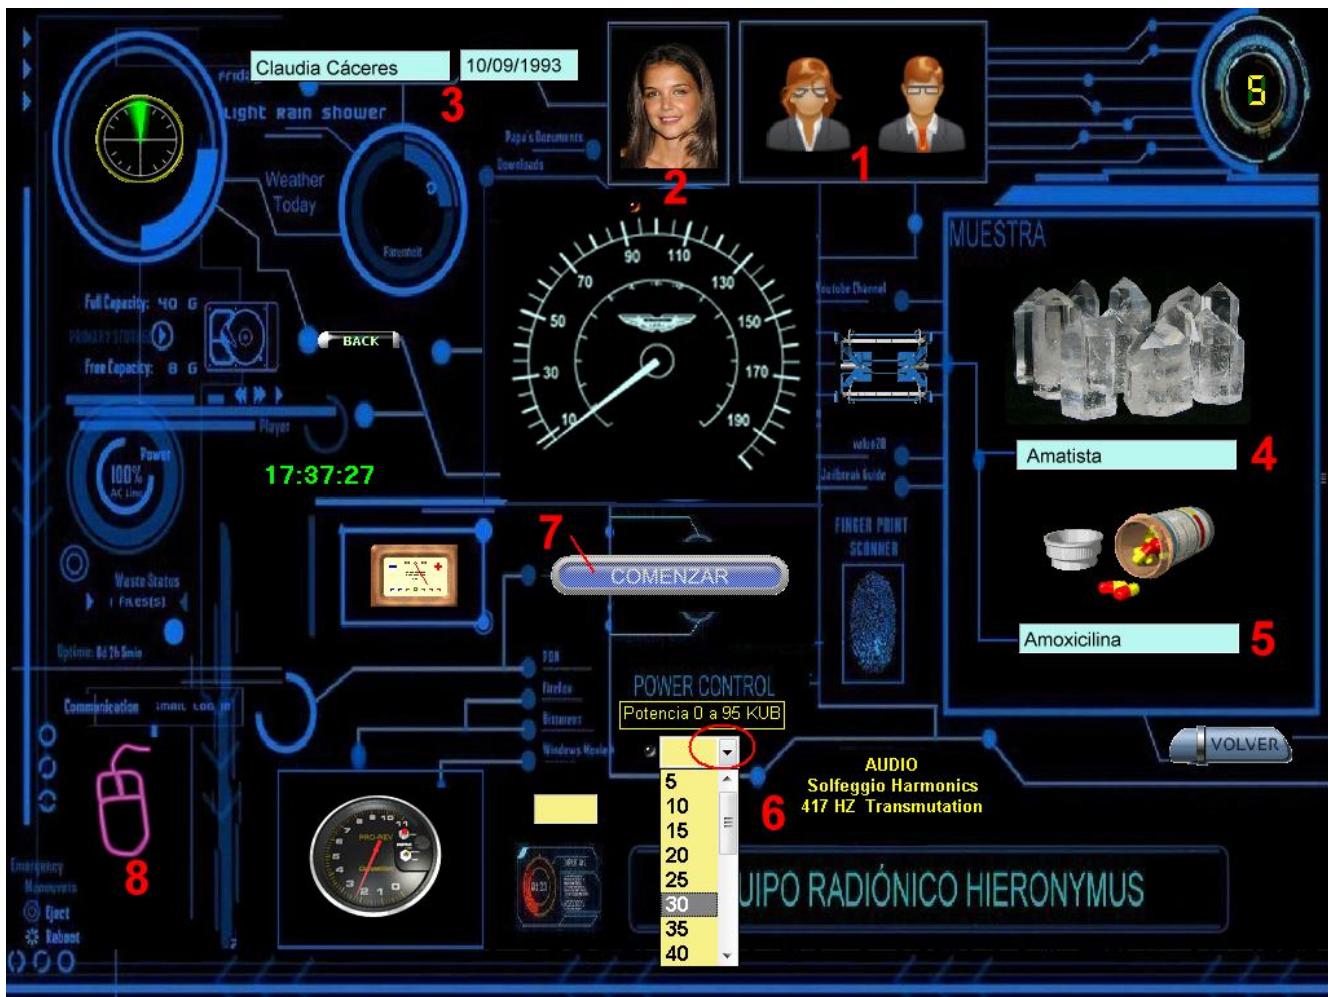

Posee el sector de selección de la persona (1) dos iconos que representan a una mujer y un hombre, y aparecerá la fotografía de la persona que vamos a tratar en el sector (2), (recuerde que previamente se ha cargado la foto como archivo "person1.jpg" o "person2.jpg" en el directorio del Radionic Power Pro); y en el sector marcado como (3) se coloca el nombre y fecha de nacimiento de la persona a tratar.

Hasta aquí es similar al inicio para aplicaciones vistas anteriormente, ahora veremos los distintos sectores que tiene esta pantalla en similitud con el equipo original.

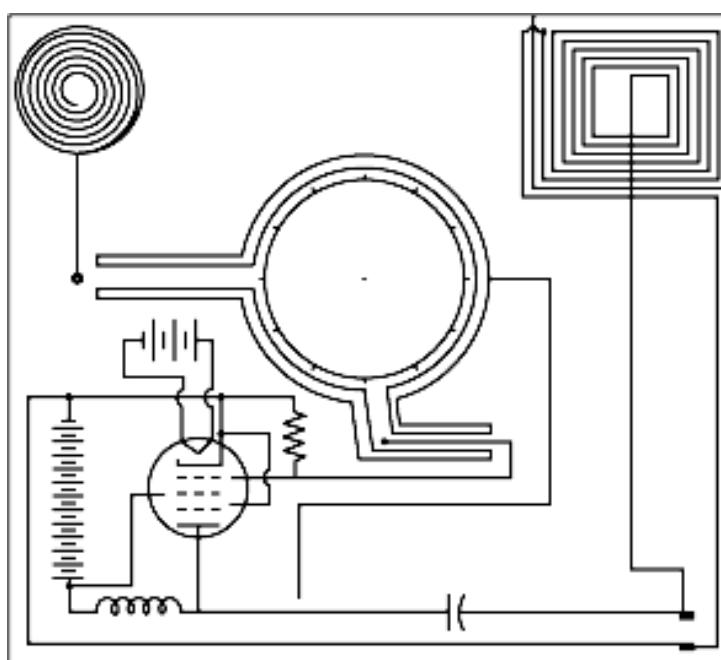

En el dispositivo hay cuatro zonas diferenciadas: la del testigo donde se pone una muestra biológica del sujeto o una foto, para nosotros el sector (2); una zona de energía donde se pone un imán, una orgonita, un cristal de gema o mineral o cualquier elemento que emita energía, para nosotros el sector indicado

como “MUESTRA”, en la cual colocaremos el nombre de un cristal o gema en el cuadro de texto (4) y/o una muestra de medicamento, cuyo nombre colocaremos en la caja de texto (5); y la zona central que hace las veces de estabilizadora y transmisora de la emisión energética proveniente de la fuente (4-5) y con destino al receptor (2). La sesión dura 4 minutos y medio y se trata de una reproducción auditiva del Solfeggio Harmonics, a 417 HZ - Transmutation”.

Puede repetirse la sesión una vez más por persona y por día.

En el sector “Power Control” (6), equivalente a la posición del transmisor, debe indicarse una cifra que corresponde a la potencia que deberá liberar el transmisor, **la cual estará entre 0 y 95 kilounidades radiativas (KUR)**. Encontrará un menú desplegable, el cual al abrilo mostrará las unidades KUR de 0 a 95 cada cinco unidades. Haga clic sobre la cantidad de unidad deseada.

¿Cómo averiguar las kilounidades KUR necesarias?

Previamente a la incorporación de los datos, es necesario que el operador conozca el estado de las geopatías de la persona o el ambiente, para ello deberá usarse del **Biómetro Bovis** (ya sea el lineal u original o circular) para saber a cuántas unidades Bovis (UB) corresponde, según el péndulo, a la dolencia o problema de la persona, y luego en una tabla especial buscar la equivalencia para obtener la cifra de kilounidades radiativas (KUR). Vea abajo la sección: **Equivalecias entre UB y KUR**.

Una vez todo dispuesto hasta aquí, el botón “COMENZAR” (7) activará el equipo, (este botón quedará inactivo hasta que no se coloquen las unidades KUR en el “Power Control”).

Este botón, (como en el original) está la zona del dial del transmisor, (con un botón móvil y la parte del detector táctil que se utilizará para tener la reacción de adherencia que permita sintonizar el dial).

El nº 8 indica la posición del icono del ratón que hay que cliquear como última maniobra después de cargar todos los datos y antes de colocar una foto o muestra del sujeto debajo del ratón, luego de haber activado el equipo con el botón (7).

Breve Introducción para el uso del Biómetro de Bovis:

Las zonas geopatológicas son lugares donde la emisión de las radiaciones electromagnéticas que emanen de la Tierra puede afectar a la salud física o psíquica de las personas. También afectan a los animales y plantas. Por el contrario proporciona vitalidad a gran parte de los insectos (puede que a todos, ya que su nivel vibracional es más bajo que el de personas, animales y plantas).

Las radiaciones que podemos encontrar en un punto geopático pertenecen todas al espectro no visible de la luz: rayos cósmicos, rayos gamma, rayos X, rayos infrarrojos, rayos ultravioletas y partículas alfa y beta. Estas radiaciones crean en su vertical una gran cantidad de iones positivos, que descompensan aún más el equilibrio iónico del aire que respiramos.

Hay que tener en cuenta que estas radiaciones, tanto en cantidad como en composición, varían según el tipo de geopatía. Son cantidades muy pequeñas, casi indetectables, pero suficientes como para alterar nuestra salud si permanecemos mucho tiempo sobre ellas. Afectan principalmente al sistema nervioso, endocrino y hormonal. La célula actúa como un circuito electrónico resonante que se ve afectado por las frecuencias electromagnéticas naturales y artificiales. El ambiente con ionización altamente positiva que producen las radiaciones electromagnéticas favorecen la aparición de radicales libres que dañan la membrana celular.

El cuerpo humano vibra entre 7000 y 8500 UB (unidades Bovis)

Biómetro Bovis

La regla biométrica fue creada por el físico francés Antoine Bovis con la colaboración del ingeniero Simonet. Fue utilizada como escala de medición el Angstrom (\AA), o unidad de medida de la largura de onda. $1\text{\AA} = \text{décima millonésima de milímetro}$.

En la primera dimensión del Biómetro, el nivel físico va de 0 a 10.000 unidades. Mide la intensidad del lugar, la vibración que tiene un efecto sobre el elemento físico del ser humano. El uso del Biómetro permite una mayor exactitud en la medida de las vibraciones sutiles del mundo que nos cerca.


Pueden ser utilizados cualesquier tipo de testimonios: biológicos (mecha de cabellos, gota de sangre o saliva sobre papel filtro, uñas, etc.), fotos, mapas, textos manuscritos o impresos, palabras, productos, etc. Se considera como medida vital óptima 6.500 unidades Bovis.

Cuando un lugar tiene una vibración superior (digamos 8.000 unidades) él nos trae un aporte de energía vital. Eso ocurre en zonas neutras y libres de corrientes telúricas y de contaminaciones varias. Ya un lugar que vibre debajo de 6.000 producirá una desvitalización sobre cualquier ser vivo que ahí permanezca.

Forma de Uso:

Al igual que en el uso de cualquier otra gráfica, colocaremos el péndulo a la mitad, formulando mentalmente la pregunta; la que yo empleo es la siguiente: "deseo ser consciente del nivel energético de [lugar, persona, alimento...]"]. Éste se moverá hacia la izquierda al centro o a la derecha. Lógicamente si el movimiento oscilante es hacia el frente nos estará señalando la media en la gráfica, y si no lo desplazaremos hacia el lado que nos señala hasta que el movimiento nos señale una medición al frente.


BIÓMETRO de A. BOVIS, fís.
completado por A. SIMONETON, ing. E.B.P.

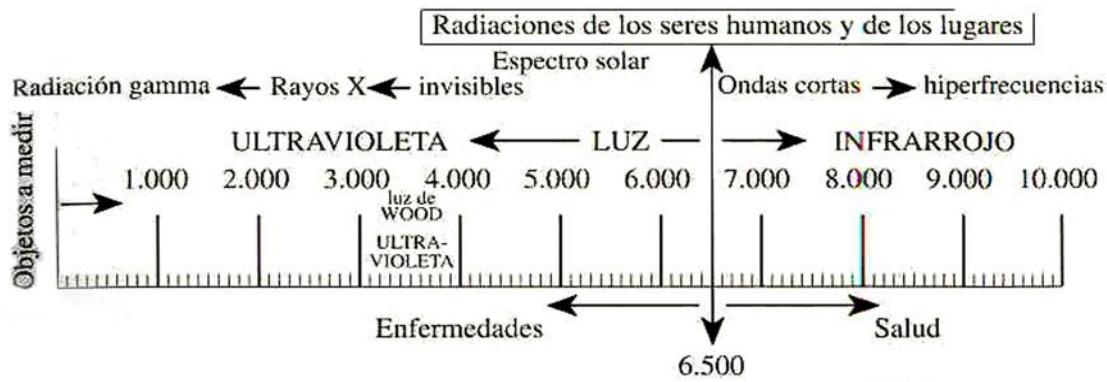

Biómetro Bovis en Angströn

Vibración en Angströn 1A= 10 millionésima de mm

- Muy perjudicial para la salud
- Banda normal estándar de salud
- Ideal para meditación
- Excelente energía psicofísica

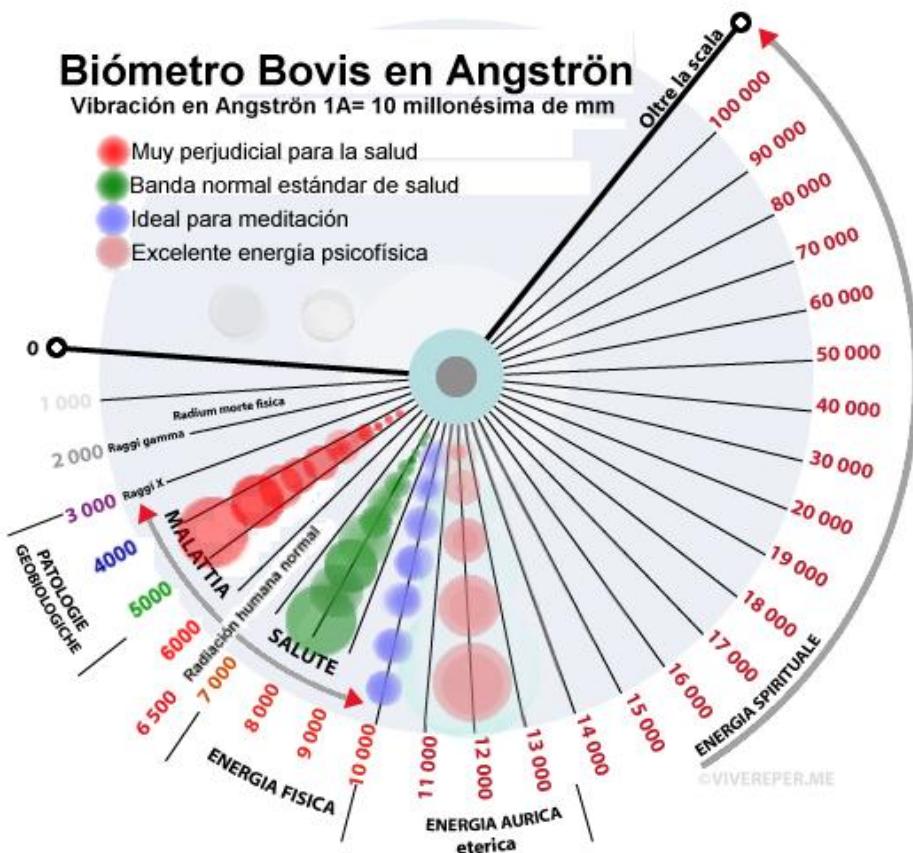

Si creemos que nos señala 7200 UB, por ejemplo, y no estamos seguros de si la medición es correcta podemos confirmarlo preguntando "¿la medición es más de 7000, más de 7100, más de 7200?", hasta que la respuesta sea negativa, o directamente preguntar "¿es correcta la medición de 7200 UB?" Otra forma de utilizarlo es situando el péndulo sobre la parte izquierda de la gráfica y mover lentamente la mano

hacia la derecha. El péndulo girará en círculos como pretendiendo adelantarnos, cuando se para sobre una medida, deja de girar y nos la indica.

Nociones de energías radiativas y no radiativas:

La transmisión inalámbrica de potencia o transmisión inalámbrica de energía fue inventada por el Ingeniero, Físico e Inventor austrohúngaro Nikola Tesla y consiste en la transmisión de energía eléctrica de una fuente de alimentación a un dispositivo sin la utilización de cables o conductor eléctrico. Es un término genérico utilizado para referirse a un distinto número de tecnologías de transmisión de energía que usan una variable de tiempo de campo electromagnético.

La transmisión inalámbrica es útil para los dispositivos de potencial eléctrico en casos en donde la utilización de cables es inconveniente, peligrosa, o no es posible. En la transmisión inalámbrica de energía, un dispositivo emisor conectado a una fuente de poder, tal como una fuente de electricidad doméstica, transmite energía por un campo electromagnético a través de un espacio intermedio a uno o más dispositivos receptores, donde es convertida de vuelta a energía eléctrica y utilizada.

Las técnicas de transferencia de energía pueden ser de dos clases, la no-radiativa y la radiativa.

En las técnicas de campo cercano o no-radiativas, la energía es transferida a través de cortas distancias por campos magnéticos usando un acoplamiento magnético entre electrones. Estas técnicas pueden transportar la energía por una distancia mayor pero deben ser dirigidas en el receptor.

Nosotros usaremos la emisión de radiates o transferencia del tipo radiativa para distancia lejana.

Equivalencias entre UB y KUR:

La siguiente tabla deberá ser utilizada para conocer la equivalencia entre las UB (unidades Bovis estándar) detectadas y las KUR (kilounidades Radiativas) que deberán colocarse en el cuadro de texto correspondiente a la potencia o frecuencia generadora a la que queremos regular el transmisor en nuestro equipo hieronymus (sector 6).

Según lo visto las unidades normales de salud en el organismo humano estarían entre 6000 y 8500 UB, con 6500 como de buena salud. Obviamente, mientras menor sea ese valor, se encuentra desmejorado el sistema de salud o el estado energético circundante es peor, entonces deberá ser mayor el valor de recarga o entrega de energía (KUR) que deberá entregarse.

La siguiente escala de equivalencias, que inicia en 8500 UB, puesto que desde ese nivel a superior las influencias son positivas, muestra que la energía radiativa en kilounidades que será necesaria aplicar será obviamente muy bajo (10), ya que no será necesaria mayor energía, mientras que, por ejemplo, con 5000 UB, muy bajo o zona de posibles enfermedades, las unidades radiativas para aplicar serán 45 KUR.

El justo medio en un biómetro Bovis para la salud normal está en los 6500 UB, que equivalen a 30 KUR. Una KiloUnidad Radiática equivale a una emisión de 1000 radiates, entonces, 30 KUR (para un organismo sano con 6500 Unidades Bovis), sería de 30000 radiates.

UB	8500	8000	7500	7000	6500	6000	5500	5000
KUR	10	15	20	25	30	35	40	45

4500	4000	3500	3000	2500	2000	1500	1000	500	<500
50	55	60	65	70	75	80	85	90	95


¿Se puede aplicar mayor energía KUR que la indicada en la escala de equivalencia? Sí, pero comenzar al menos las 3 primeras sesiones con el valor indicado por la escala y luego de hacer nuevas evaluaciones con el péndulo y si los límites UB siguen siendo bajos, se pueden incrementar de a 10 KUR cada dos sesiones.

APLICACIONES CON GRAFICAS RADIONICAS DE TRATAMIENTO:

Llegamos aquí al haber hecho clic sobre el botón “RADIÓNICA HOLOGRÁMICA” de la pantalla de aplicaciones primarias. Esta es la pantalla de aplicaciones de teleradionica o tratamiento radionico a distancia, dentro hay dos modelos o secciones para elegir, y se ha elegido el uso de Gráficas Radionicas de Tratamiento (2).

INTRODUCCIÓN:


Las Tarjetas de Onda de Formas corresponden al grupo de Gráficas Radiónicas de Protección (distinguiéndose de las de Diagnosis), donde la expresión cuántica de onda de forma adquiere su mayor magnitud.

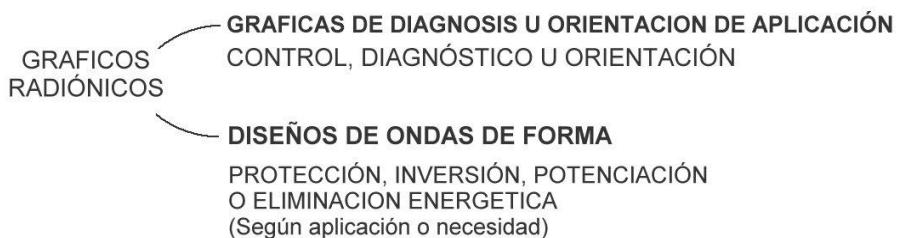

En el tratamiento a distancia y en directo se pueden utilizar una serie de gráficos que tienen capacidad para portar un efecto o la influencia de un medicamento, se le llaman gráficos radiónicos, radiestésicos o psíónicos; se podrían clasificar en esta última categoría, pues la psiónica utiliza elementos geométricos y de forma para canalizar la energía hacia el objeto de la acción. Son propios de la radiestesia francesa y belga, los más conocidos son los realizados por los hermanos Servranx de Bélgica a partir de los años 50 del siglo XX.

La base teórica de su funcionamiento se basa en las denominadas “ondas de forma”, que surgen de los estudios de los radiestesistas franceses de principios del siglo XX, sobre todo de Chaumery y De Belizal. El tema de las ondas es muy extenso en la radiónica y en radiestesia, por la energía que pueden emitir las figuras geométricas y que sirven como portadoras de la influencia deseada a enlazarse con el sujeto a influir. Se basan en modelos geométricos tradicionales y considerados sagrados por distintas culturas, aunque existen múltiples adaptaciones y variaciones; se pueden realizar geometrías personalizadas de ondas de forma por medios radiestésicos.

Pantalla de Selección de Gráfica Radiónica coadyuvante para Tratamientos:


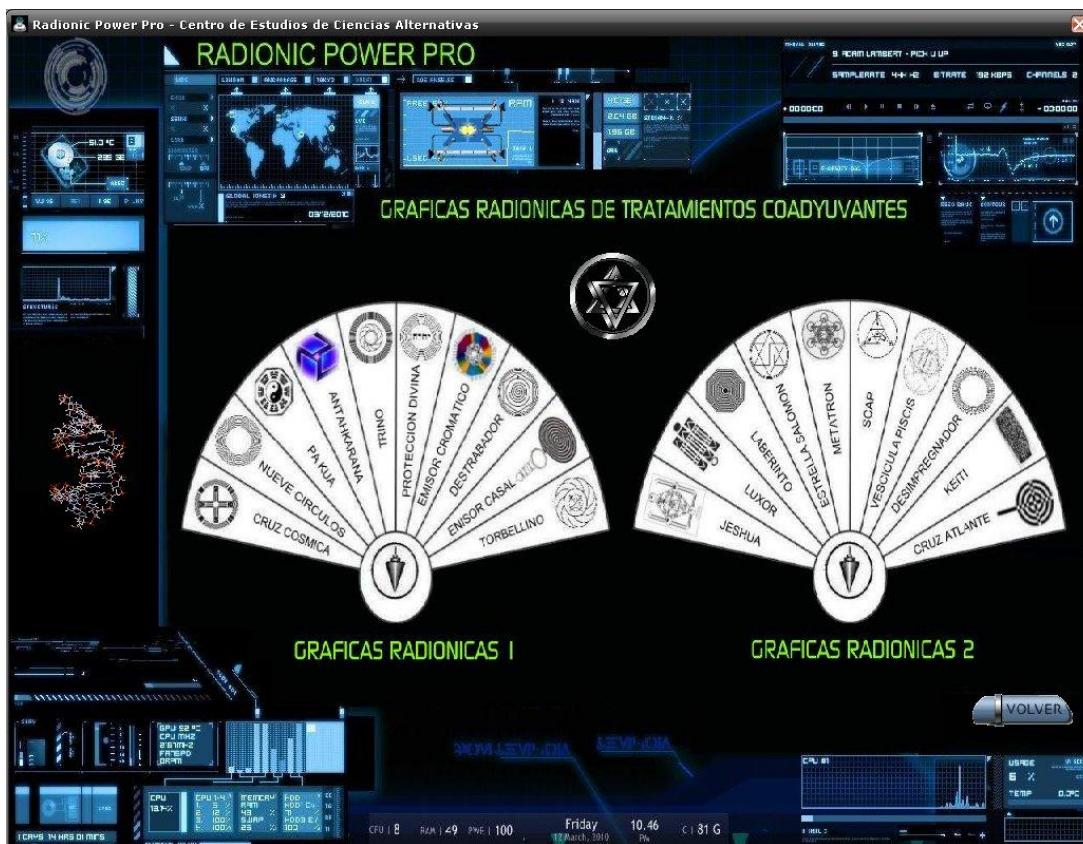


La página contiene exclusivamente las imágenes de las dos gráficas de diagnosis (conteniendo 10 iconos cada una), y el operador sólo debe hacer clic sobre el dibujo de la gráfica de onda de forma recomendada por el péndulo, automáticamente al seleccionar el tipo de gráfica buscado el programa pasará inmediatamente a la próxima pantalla.

Recuerde que, previamente, es necesario saber cuál es la gráfica radiónica de tratamiento que usaremos, para lo cual tendremos que haber evaluado las posibilidades según las necesidades de la persona, y con el péndulo sobre 2 gráficas de diagnosis incluidas al efecto.

Es posible que las gráficas de diagnosis recomienden la aplicación de más de un gráfico de onda de forma de tratamiento, pero **deberá usarse solo una por vez y por sesión.**

Aquí tiene las Graficas Radiónicas de Diagnóstico para imprimir:

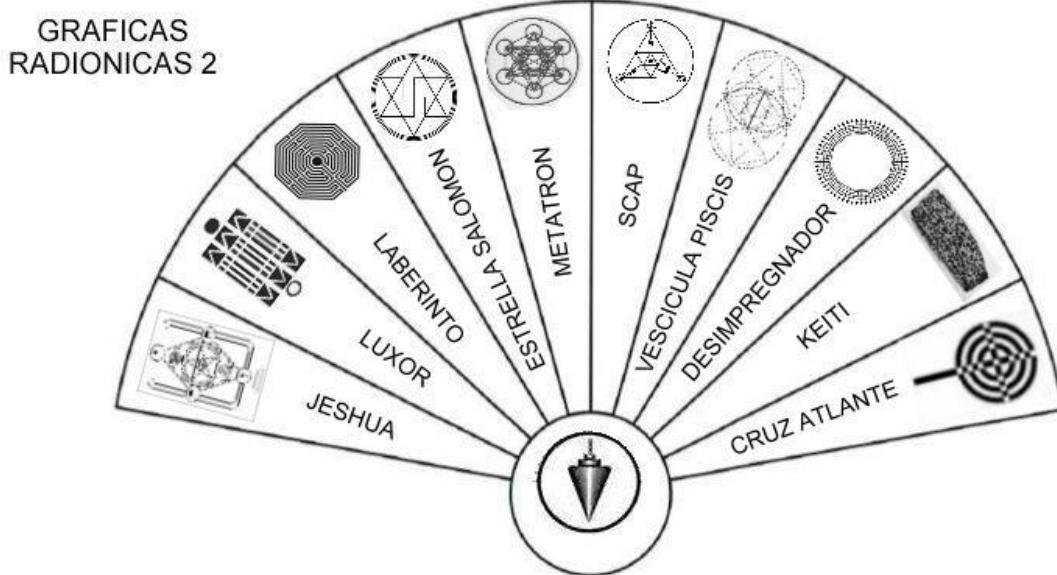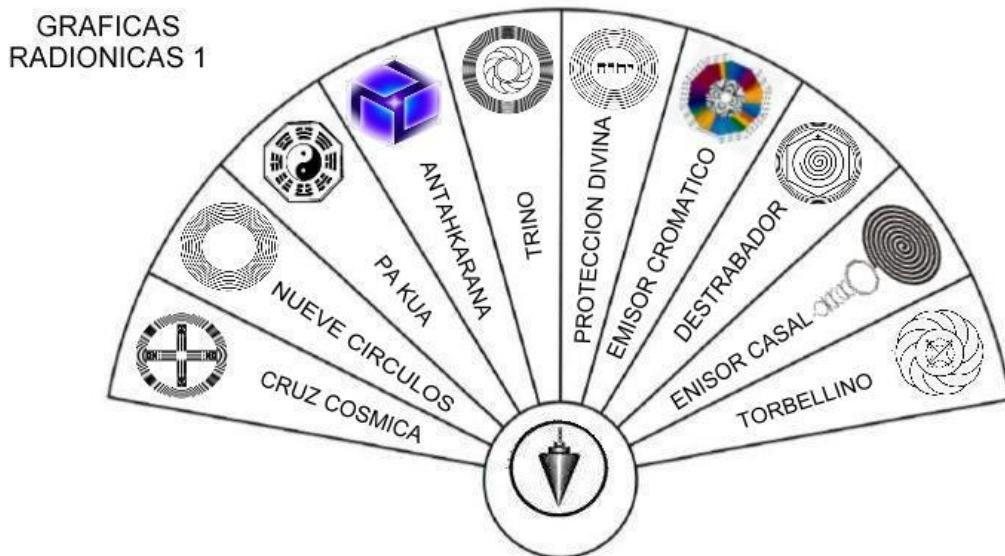

Detalles de la Pantalla de Aplicación:

Posee el sector de selección de la persona (1) dos iconos que representan a una mujer y un hombre, y aparecerá la fotografía de la persona que vamos a tratar en el sector (2), (recuerde que previamente se ha cargado la foto como archivo “person1” o “person2” en el directorio del Radionic Power Pro); y en el sector (3) se alojan el nombre la fecha de nacimiento de la persona a tratar.

Luego, en el cuadro de texto (4) se colocará el lugar (ciudad, comarca o provincia) desde donde se hará la emisión y debajo, en el cuadro de texto (5), el nombre del lugar donde se encuentra el receptor o la persona a tratar.



En el ejemplo de la pantalla se muestra una emisión que se hará desde Málaga hacia Alicante para una persona varón cuya gráfica radiónica recomendada es el “Emisor Cromático”.

Cuando todo esté dispuesto hasta este punto, solo queda por cliquear sobre el botón (6), señalado por la palabra “ACTIVAR”, y dará comienzo la sesión, que dura unos 4 minutos.

El sector nº 7 indica la posición del ícono del ratón que hay que cliquear como última maniobra después de cargar todos los datos y antes de colocar una foto o muestra del sujeto debajo del ratón.

Puede repetir la sesión una vez más, si lo desea, o para elegir otra gráfica radiónica de tratamiento, solo basta con salir de la pantalla de aplicaciones haciendo clic sobre el botón “VOLVER”, e ingresar nuevamente a la pantalla anterior con las gráficas de diagnosis y podrá elegirse otra, al ingresar otra vez en la pantalla de aplicaciones los datos se habrán eliminado teniendo en cuenta que se operará sobre otra persona.

¿Solo para Aplicaciones en personas?

Si se tratara de realizar aplicaciones sobre casas, vehículos, campos etc, el efecto será el mismo colocando la foto del dueño o relacionada con el lugar.